



Posey® Twice-As-Tough® Cuffs 2790, 2790Q

Application Instructions for Wrist and Ankle



Posey®

Rx ONLY

DESCRIPTION OF PRODUCT: Padded limb restraints with double-security closure. For bed and stretcher use only.

INTENDED USE:

- Patients assessed to be at risk of disrupting life-saving treatments (e.g., chronic tube pulling) or in danger of injury to themselves or to others.
- Follow your hospital's restraint policies and procedures which are in compliance with USA CMS guidelines and state laws, or other governing agencies outside the USA.

CONTRAINdications:

Do not use this device with someone who has continued highly aggressive or combative behavior, self-destructive behavior, or deemed to be an immediate risk to others or to self. Clinicians may need to use additional interventions in conjunction with restraints.

APPLICATION INSTRUCTIONS:

Use method a. or b. below to attach straps to frame (repeat steps 1-2 on each side):

1a. Triangulation process; to restrict patient's range of motion: separate the straps and attach at different points along the frame that moves with the patient (Fig. 1) out of patient's reach (do not attach to side rail or head/footboard) (Fig. 2).

1b. To increase patient's range of motion: place the straps together and attach to a single point along a part of the frame that moves with the patient, out of the patient's reach.


2. **2790:** Wrap the connecting strap to the frame by pulling the strap back between the first and second D-ring (Fig. 3).

2790Q: Wrap the connecting strap once around the frame that moves with the patient, out of the patient's reach. Close the quick-release buckle. Listen for a "snapping" sound. Pull firmly on straps to ensure a good connection (Fig. 4).

APPLYING THE CUFFS:

(Repeat steps 1-4 for each side):
1. Wrap the neoprene piece around wrist/ankle so the buckle and connecting strap is on the ulnar side of the wrist or lateral malleolus of the ankle. Attach the black hook-and-loop pieces together and pull back the black pull tab on the blue or red fuzzy piece, followed by the blue or red hook-and-loop pieces. The fuzzy piece should be sandwiched between the two pieces of hook (Fig. 5). Be sure to overlap at least one inch (3 cm).

2. Press the hook-and-loop closure together firmly and make sure it adheres securely. Slide ONE finger (flat) between the cuff and the inside of the patient's wrist/ankle to ensure proper fit. (Fig. 6)

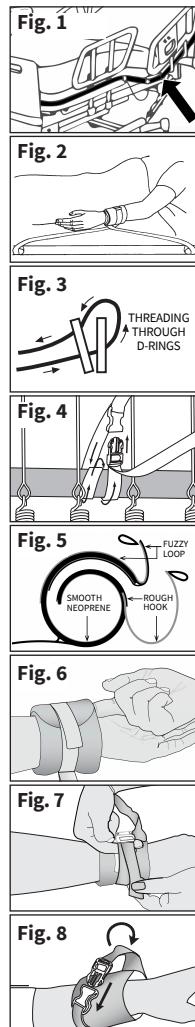

2790



2790Q

POSEY TWICE-AS-TOUGH CUFFS:

REF 2790 Double Strap, Regular/blue size

REF 2790Q Double Strap with Quick-Release Buckles, Regular/blue size

3. **2790:** Pass the end of the limb strap over the top of the cuff and through the two D-rings on the cuff. Bring the strap back over the first ring and through the two D-rings on the cuff. Slide one finger flat between the cuff and the strap.

2790Q: Close the quick-release buckle on the cuff. Insert ONE finger (flat) under the buckle and pull the strap snug, but not so tight as to restrict circulation (Fig 7). Release the quick-release buckle, twist buckle 180°, and reconnect (Fig 8). Listen for a "snapping" sound.

4. Adjust the connecting strap(s) length from the frame to allow desired freedom of movement without compromising patient or caregiver safety. Ensure the remaining strap end(s) are secured and out of the reach of the patient.

PRECAUTIONS:

- A clinical assessment and decision are required when used with monitoring lines or if patient has a wound or dislocated/fractured limb.
- Check the patient regularly to ensure that circulation is not impaired. Serious injury may occur if the cuffs restrict circulation when the limb holder is applied.
- Before each use, check cuffs and straps for cracks, tears, and/or excessive wear or stretch, broken buckles or locks, and/or that hook-and-loop adheres securely as these may allow patient to remove cuff. Discard if device is damaged or if unable to lock.
- WARNING:** Additional or different body or limb restraints may be needed (visit tidiproducts.com):
 - If the patient pulls violently against the bed straps.
 - To reduce the risk of the patient getting access to the line/wound/tube site.
 - To prevent the patient from flailing or bucking up and down and causing self-injury.

BED SAFETY:

Refer to the Food and Drug Administration (FDA), or other governing agencies outside the USA, for the most recent Hospital Bed Safety Guidelines and the bed manufacturer's instructions for use.

EN

Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. | Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at www.tidiproducts.com/IFU.

ADDITIONAL SAFETY AND LAUNDERING INSTRUCTIONS ON OTHER SIDE.

TIDI

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Phone: 1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. All rights reserved.

EC REP

MD CE

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany

UK
CA

UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24BZ
United Kingdom

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



Posey® Twice-As-Tough® Manschetten 2790, 2790Q

Anwendungshinweise für Hand- und Fußgelenk



Posey®

NUR für den behandelnden Arzt

PRODUKTBESCHREIBUNG:

Gepolsterte Rückhaltevorrichtungen mit doppeltem Sicherheitsverschluss. Nur für den Gebrauch an Bett und Krankentrage.

VERWENDUNGSZWECK:

- Patienten, bei denen das Risiko besteht, lebensrettende Behandlungen zu unterbrechen (z. B. dauerhaftes Herausziehen des Tubus) oder wenn Verletzungsgefahr für sie selbst oder andere besteht.
- Befolgen Sie die Vorschriften und Verfahren für Rückhaltevorrichtungen Ihres Krankenhauses in Übereinstimmung mit den amerikanischen CMS-Richtlinien und den Landesgesetzen oder anderen Richtlinien der Aufsichtsbehörden außerhalb der USA.

KONTRAINDIKATIONEN: Verwenden Sie dieses Produkt nicht bei Patienten, die dauerhaft sehr aggressiv, streitlustig oder selbstzerstörerisch sind oder als unmittelbare Gefahr für sich oder andere eingeschätzt werden. Die Klinikärzte müssen ggf. zusätzliche Maßnahmen in Verbindung mit den Rückhaltevorrichtungen ergreifen.

ANWENDUNGSHINWEISE:

Verwenden Sie die untenstehende Methode a. oder b., um die Gurte am Bettrahmen zu befestigen (Schritte 1 und 2 auf jeder Seite wiederholen):

1a. Triangulationsverfahren; zur Begrenzung des Bewegungsbereichs des Patienten: Trennen Sie die Gurte und befestigen Sie sie außerhalb der Reichweite des Patienten an verschiedenen Stellen an dem Bettrahmen, der mit dem Patienten bewegt wird (Abb. 1) (nicht am Seitengitter oder Kopf-/Fußende befestigen) (Abb. 2).

1b. Zur Erweiterung des Bewegungsbereichs des Patienten: Legen Sie die Gurte zusammen und befestigen Sie sie außerhalb der Reichweite des Patienten an einer einzigen Stelle an einem Teil des Bettrahmens, der mit dem Patienten bewegt wird.

2. **2790:** Wickeln Sie den Verbindungsgurt um den Rahmen, indem Sie den Gurt durch den ersten und zweiten D-Ring zurückziehen (Abb. 3).


2790Q: Wickeln Sie den Verbindungsgurt außerhalb der Reichweite des Patienten einmal um den Rahmen, der mit dem Patienten bewegt wird. Schließen Sie die Schnalle des Schnellverschlusses. Es muss ein Einschnapgeräusch zu hören sein. Ziehen Sie fest an den Gurten, um eine gute Verbindung zu gewährleisten (Abb. 4).

ANLEGEN DER MANSCHETTEN:

(Schritte 1 bis 4 für jede Seite wiederholen):

1. Wickeln Sie das Neoprenteil um das Hand-/Fußgelenk des Patienten, sodass sich Schnalle und Verbindungsgurt auf der Ellenseite des Handgelenks oder am Außenknöchel des Fußgelenks befinden. Befestigen Sie die schwarzen Klettverschlüsse und ziehen Sie die schwarze Aufreißlasche auf dem blauen oder roten weichen Stück zurück, dann die blauen oder roten Klettverschlüsse. Legen Sie das weiche Stück zwischen den beiden Hakenstücken ein (Abb. 5). Es muss mindestens 3 cm überlappen.

2. Drücken Sie den Klettverschluss fest zusammen und vergewissern Sie sich, dass er sicher haftet. Schieben Sie EINEN Finger (flach) zwischen die Manschette und die Innenseite des Hand-/Fußgelenks des Patienten, um einen korrekten Halt zu gewährleisten. (Abb. 6)

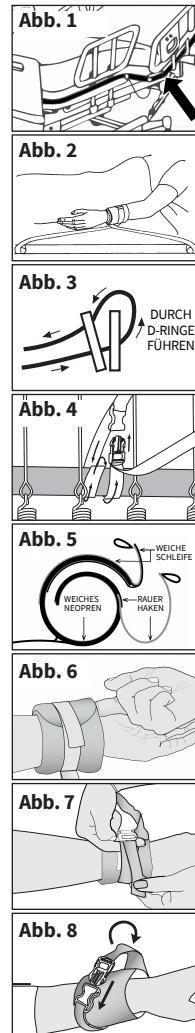

2790



2790Q

POSEY TWICE-AS-TOUGH MANSCHETTEN:

REF 2790 Doppelgurt, normale Größe/blau

REF 2790Q Doppelgurt mit Schnellverschluss-Schnalle, normale Größe/blau

3. **2790:** Führen Sie das Ende des Rückhaltegurts über die Oberseite der Manschette und durch die beiden D-Ringe an der Manschette. Führen Sie den Gurt zurück über den ersten Ring und durch die beiden D-Ringe an der Manschette. Schieben Sie einen Finger flach zwischen die Manschette und den Gurt.

2790Q: Schließen Sie die Schnalle des Schnellverschlusses an der Manschette. Stecken Sie EINEN Finger (flach) unter die Schnalle und ziehen Sie den Gurt straff, aber nicht zu fest, um die Durchblutung nicht zu beeinträchtigen (Abb. 7). Lösen Sie die Schnalle des Schnellverschlusses, drehen Sie die Schnalle um 180° und schließen Sie sie wieder (Abb. 8). Es muss ein Einschnapgeräusch zu hören sein.

4. Stellen Sie die Länge der Verbindungsgurte vom Bettrahmen aus ein, um die gewünschte Bewegungsfreiheit zu gewährleisten, ohne die Sicherheit des Patienten oder des Pflegepersonals zu beeinträchtigen. Vergewissern Sie sich, dass die verbleibenden Gurtenden gesichert und außerhalb der Reichweite des Patienten sind.

VORSICHTSMASSNAHMEN:

- Bei Einsatz von Überwachungslinien oder wenn der Patient eine Wunde oder verrenkte/ gebrochene Extremitäten hat, sind im Vorfeld eine klinische Begutachtung und Entscheidung erforderlich.
- Überprüfen Sie den Patienten regelmäßig, um sicherzustellen, dass die Durchblutung nicht beeinträchtigt ist. Schwere Verletzungen können auftreten, wenn die Manschetten bei angelegter Extremitätenhalterung die Durchblutung einschränken.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch Manschetten und Gurte auf Risse, Brüche und/ oder übermäßige Abnutzung oder Dehnung, gebrochene Schnallen oder Schlosser und/oder die sichere Haftung von Klettverschlüssen, damit der Patient die Manschette nicht entfernen kann. Entsorgen Sie beschädigte Produkte oder solche, die sich nicht verschließen lassen.
- ! WARNUNG:** Es können zusätzliche oder andere Rückhaltevorrichtungen für Körper oder Extremitäten erforderlich sein (siehe tidiproducts.com):
 - Wenn der Patient heftig an den Bettgurten zieht
 - Um das Risiko zu verringern, dass der Patient Zugang zu den Leitungen/Wunden/Schläuchen erhält
 - Um zu verhindern, dass der Patient sich auf- und abbewegt und sich selbst verletzt.

BETTSICHERHEIT:

Für die aktuellsten Sicherheitsrichtlinien für Krankenhausbetten wird auf die Zulassungsbehörde FDA (Food and Drug Administration) oder andere Aufsichtsbehörden außerhalb der USA sowie auf die Gebrauchsanweisung des Bettenherstellers verwiesen.

DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates. Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf www.tidiproducts.com/IFU.

ZUSÄTZLICHE HINWEISE ZUR SICHERHEIT SOWIE ANLEITUNGEN ZUM WASCHEN BEFINDEN SICH AUF DER RÜCKSEITE.

EN

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefon: +1 800 447 6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Alle Rechte vorbehalten.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Deutschland

UK Verantwortliche Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Vereinigtes Königreich

UK CA

Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



Brazaletes Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q

Instrucciones de aplicación para muñeca y tobillo



Solo con receta médica.

ESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Correas de seguridad acolchadas para extremidades con doble cierre de seguridad.
Solo para uso en camas y camillas.

USO PREVISTO:

- Pacientes evaluados como en riesgo de interrumpir tratamientos vitales (p. ej., extracción de tubos crónicos) o en peligro de lesionarse a sí mismos o a otros.
- Siga las políticas y procedimientos de sujeción de su hospital que cumplan con las directrices de los CMS de EE. UU. y las leyes estatales, u otras agencias gubernamentales fuera de los EE. UU.

CONTRAINDICACIONES:

No utilice este dispositivo en alguien con un comportamiento muy agresivo o combativo constante, un comportamiento autodestructivo o que se considere un riesgo inmediato para sí mismo o para otros. Es posible que los profesionales clínicos necesiten utilizar intervenciones adicionales junto con las correas de seguridad.

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

Utilice el método a. o b. a continuación para sujetar las correas 1-2 en cada lado:

1a. Proceso de triangulación; para restringir el rango de movimiento del paciente: separe las correas y fíjelas en distintos puntos a lo largo del marco que se mueve con el paciente (Fig. 1) fuera del alcance de este (no las sujeté a la barandilla lateral ni al cabecero o a los pies de la cama) (Fig. 2).

1b. Para aumentar el rango de movimiento del paciente: coloque las correas juntas y fíjelas en un solo punto a lo largo de una parte del marco que se mueve con el paciente fuera del alcance de este.

2. **2790:** Enrolle la correa de conexión al marco tirando de la correa hacia atrás entre la primera y la segunda anilla en D (Fig. 3).


2790Q: Enrolle la correa de conexión una vez alrededor del marco que se mueve con el paciente fuera del alcance de este. Cierre la hebilla de liberación rápida del brazalete. Deberá escuchar un sonido de chasquido. Tire firmemente de las correas para asegurar una buena conexión (Fig. 4).

EMPLEO DE LOS BRAZALETES:

(Repite los pasos 1-4 para cada lado):

1. Envuelva la pieza de neopreno alrededor de la muñeca/tobillo de modo que la hebilla y la correa de conexión estén en el lado cubital de la muñeca o en el maléolo lateral del tobillo. Una las piezas negras de velcro y tire de la lengüeta negra de la pieza mullida azul o roja, seguida de las piezas azules o rojas de velcro. La pieza mullida deberá colocarse entre las dos piezas de gancho (Fig. 5). Asegúrese de superponer al menos 3 cm.

2. Presione el cierre de velcro con firmeza y asegúrese de que esté adherido de forma segura. Deslice UN dedo (plano) entre el brazalete y el interior de la muñeca/tobillo del paciente para asegurar un ajuste adecuado. (Fig. 6)

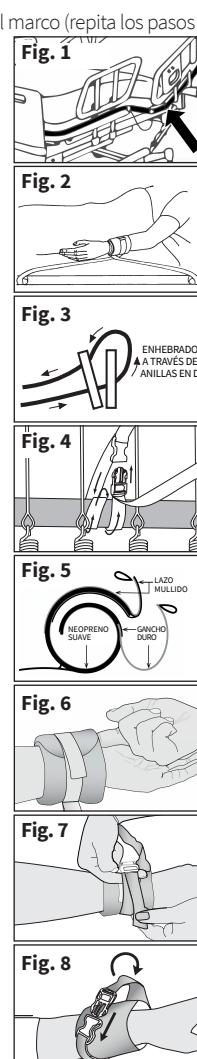

2790



2790Q

BRAZALETES POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Doble correa, tamaño normal/azul

REF 2790Q Correa doble con hebilla de liberación rápida, tamaño normal/azul

3. **2790:** Pase el extremo de la correa de la extremidad sobre la parte superior del brazalete y a través de las dos anillas en D de este. Vuelva a colocar la correa sobre la primera anilla y a través de las dos anillas en D del brazalete. Deslice UN dedo entre el brazalete y la correa.

2790Q: Cierre la hebilla de liberación rápida del brazalete. Inserte UN dedo (plano) debajo de la hebilla y tire de la correa para que quede ceñida, pero no tan apretada como para restringir la circulación (Fig. 7). Suelte la hebilla de liberación rápida, gírela 180° y vuelva a conectarla (Fig. 8). Deberá escuchar un sonido de chasquido.

4. Ajuste la longitud de las correas de conexión desde el marco para permitir la libertad de movimiento deseada sin comprometer la seguridad del paciente o del cuidador. Asegúrese de que los extremos restantes de la correa estén protegidos y fuera del alcance del paciente.

PRECAUCIONES:

- Se requiere una decisión y evaluación clínica cuando se use con vías de monitorización o si el paciente tiene una herida o una extremidad dislocada/fracturada.
- Revise al paciente con regularidad para asegurarse de que la circulación no se vea afectada. Pueden producirse lesiones graves si los brazaletes restringen la circulación cuando se coloca el soporte para extremidades.
- Antes de cada uso, compruebe que los brazaletes y las correas no presenten grietas, rasgaduras y/o desgaste o estiramiento excesivo, hebillas o cerraduras rotas y/o que el velcro se adhiera de forma segura, ya que pueden permitir que el paciente se quite el brazalete. Desechar si el dispositivo está dañado o no se puede bloquear.
- ADVERTENCIA:** Es posible que se necesiten correas de seguridad distintas o adicionales para el cuerpo o las extremidades (visite tidiproducts.com):
 - si el paciente tira violentamente de las correas de la cama;
 - para reducir el riesgo de que el paciente tenga acceso al sitio de la vía/herida/sonda;
 - para evitar que el paciente se sacuda o se mueva hacia arriba y hacia abajo y se autolesione.

SEGURIDAD EN LA CAMA:

Póngase en contacto con la Administración de Medicamentos y Alimentos de los EE. UU. (FDA) u otras agencias gubernamentales fuera de los EE. UU. para obtener información sobre las directrices de seguridad para camas de hospital más recientes y las instrucciones de uso del fabricante de la cama.

ES Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro. | Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en www.tidiproducts.com/IFU.

INSTRUCCIONES ADICIONALES DE SEGURIDAD Y LAVADO EN LA OTRA CARA.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EE. UU.
Teléfono: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Reservados todos los derechos.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Alemania

UK Persona Responsable
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



SUR PRESCRIPTION UNIQUEMENT

DESCRIPTION DU PRODUIT: manchons de contention pour les extrémités, rembourrés et munis de fermeture à double sécurité. Réservé exclusivement à l'emploi sur lits ou brancards.

UTILISATION PRÉVUE:

- Patients jugés à risque de perturber les traitements vitaux (p. ex. qui retirent continuellement leurs tubulures) ou présentant un danger pour eux-mêmes ou autrui.
- Veuillez suivre les politiques et les procédures de contention de votre hôpital, en conformité avec les directives des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), les lois locales des États-Unis ou, en dehors des États-Unis, d'autres autorités de réglementation.

CONTRE-INDICATIONS:

Ne pas utiliser ce dispositif avec les personnes qui continuent à présenter un comportement très agressif, belliqueux ou autodestructeur, ou qui sont considérées représenter un risque immédiat pour elles-mêmes ou autrui. Les cliniciens peuvent avoir besoin d'interventions supplémentaires en complément de la contention.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION:

Veuillez utiliser la méthode a. ou b. ci-dessous pour fixer les courroies au cadre (répétez les étapes 1-2 des deux côtés):

1a. Procédure de triangulation ; pour limiter le champ de mobilité du patient: séparez les courroies et fixez-les à différents points du cadre qui se déplace avec le patient (Fig. 1) et hors de portée de celui-ci (ne pas les fixer aux barrières latérales ni à la tête ou au pied du lit) (Fig. 2).

1b. Pour élargir le champ de mobilité du patient : placez les courroies ensemble et fixez-les à un point unique sur une partie du cadre qui se déplace avec le patient, hors de portée de celui-ci.

2. **2790:** Enroulez la courroie de connexion au cadre en tirant la courroie vers l'arrière, entre le premier et le deuxième anneau en D (Fig. 3).







2790Q: Enroulez la courroie de connexion pour un tour autour du cadre qui se déplace avec le patient, hors de portée de celui-ci. Fermez la boucle à ouverture rapide. Vous devez entendre un claquement. Tirez fermement sur les courroies pour assurer une bonne connexion (Fig. 4).

APPLICATION DES ATTACHE-POIGNETS/CHEVILLES:

(Répétez les étapes 1 à 4 des deux côtés):

1. Enroulez la pièce de néoprène autour du poignet ou de la cheville de façon que la boucle et la courroie de connexion se trouvent du côté cubital du poignet ou de la malléole externe de la cheville. Fixez les fermetures auto-agrippantes noires et tirez vers l'arrière la languette noire sur la pièce velours bleue ou rouge, puis les pièces auto-agrippantes bleues ou rouges. La pièce duveteuse doit être prise en sandwich entre les deux pièces à crochets (Fig. 5). Assurez un chevauchement d'au moins 3 cm (un pouce).

2. Appuyez fermement sur la fermeture auto-agrippante pour vous assurer qu'elle adhère bien. Faites glisser UN doigt (à plat) entre les attache-poignets/chevilles et l'intérieur du poignet ou de la cheville du patient pour assurer un ajustement correct. (Fig. 6)



2790



2790Q

ATTACHE-POIGNETS/CHEVILLES POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Double courroie, taille standard/bleue

REF 2790Q Double courroie avec boucles à ouverture rapide, taille standard/bleue

3. **2790:** Passer l'extrémité de la courroie du membre par-dessus l'attache-poignets/chevilles et à travers les deux anneaux en D de l'attache-poignets/chevilles. Ramenez la courroie vers l'arrière sur le premier anneau et à travers les deux anneaux en D de l'attache-poignets/chevilles. Glisser un doigt à plat entre l'attache-poignets/chevilles et la courroie.

2790Q: Verrouiller la boucle à ouverture rapide sur l'attache-poignets/chevilles. Insérer UN doigt (à plat) sous la boucle et tirer la courroie pour l'ajuster, sans trop la serrer au risque d'entraver la circulation (Fig. 7). Déverrouillez la boucle à ouverture rapide, tournez-la à 180° et reconnectez-la (Fig. 8). Vous devez entendre un claquement.

4. Ajuster la longueur des courroies de connexion avec le cadre pour permettre la liberté de mouvement souhaitée, sans compromettre la sécurité du patient ou du soignant. S'assurer que les extrémités restantes des sangles soient bien attachées, hors de portée du patient.

PRÉCAUTIONS:

- Une évaluation et une décision cliniques sont nécessaires si le dispositif est utilisé avec des câbles de surveillance ou si le patient présente une plaie, une fracture ou une luxation du membre en question.
- Contrôlez régulièrement le patient afin de vous assurer que la circulation n'est pas entravée. Des lésions graves peuvent survenir si les attache-poignets/chevilles entravent la circulation lors de la contention des membres.
- Avant chaque utilisation du dispositif, vérifier que les attache-poignets/chevilles et les courroies ne présentent pas de fissures, déchirures et/ou usure ou étiènement excessif, de boucles ou serrures cassées, et que les fermetures auto-agrippantes adhèrent fermement, afin que le patient ne puisse pas retirer les attache-poignets/chevilles.
- Éliminez le dispositif s'il est endommagé ou ne peut pas être verrouillé.
- MISE EN GARDE:** Une contention supplémentaire ou différente pour le corps ou des membres peut être nécessaire (veuillez visiter le site tidiproducts.com):
 - si le patient tire violemment sur les courroies du lit;
 - pour réduire le risque d'accès du patient aux câbles, plaies ou tubulures;
 - pour empêcher le patient de s'agiter ou de se cabrer de façon à se blesser.

SÉCURITÉ DES LITS:

Veuillez vous reporter à la Food and Drug Administration (FDA), ou aux autorités compétentes si en dehors des États-Unis, pour les directives actualisées sur la sécurité des lits d'hôpitaux, ainsi qu'aux instructions d'utilisation des fabricants de lits..

FR

Signalez tout incident grave lié à l'utilisation du dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. | Les traductions de ce document en allemand, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais sont disponibles sur le site www.tidiproducts.com/IFU.

INSTRUCTIONS SUPPLÉMENTAIRES DE SÉCURITÉ ET DE NETTOYAGE AU VERSO.

EN

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Téléphone : +1 800 447 6739 • International : +1 920 751 4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tous droits réservés.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne

UK Responsible
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24BZ
Royaume-Uni

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



Bracciali Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q

Istruzioni per l'applicazione su polsi e caviglie



Posey®

Rx ONLY

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO: strumenti di contenzione degli arti con imbottitura e chiusura a due livelli di sicurezza. Da utilizzarsi esclusivamente su letto e barella.

DESTINAZIONE D'USO:

- Pazienti considerati a rischio di interrompere trattamenti salvavita (ad es., rimozione di un tubo a lunga permanenza) o che possono causare lesioni a sé stessi o agli altri.
- Seguire le politiche e le procedure di contenzione dell'ospedale conformi alle linee guida dei CMS statunitensi e alle normative statali o di altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti.

CONTROINDICAZIONI: Non utilizzare questo dispositivo su persone che mostrano un comportamento altamente aggressivo o violento continuo, un comportamento autodistruttivo o che siano ritenute un pericolo immediato per loro stesse o per gli altri. I medici potrebbero dover adottare misure aggiuntive oltre ai dispositivi di contenzione.

ISTRUZIONI PER L'APPLICAZIONE:

Utilizzare il metodo a. o b. qui di seguito per fissare le cinghie al telaio (ripetere i passaggi 1-2 per ciascun lato):

1a. Processo di triangolazione; per limitare il raggio di movimento del paziente: separare le cinghie e fissarle in punti differenti lungo il telaio che si muove con il paziente (Fig. 1), lontano dalla portata del paziente (non fissarle alla guida laterale o alla testiera/pediera) (Fig. 2).

1b. Per aumentare il raggio di movimento del paziente: unire insieme le cinghie e fissarle in un solo punto lungo la parte del telaio che si muove con il paziente, lontano dalla portata del paziente.








2. **2790:** avvolgere la cinghia di connessione attorno al telaio tirando la cinghia indietro tra il primo e il secondo anello a D (Fig. 3).

2790Q: avvolgere la cinghia di connessione una volta attorno al telaio che si muove con il paziente, lontano dalla portata del paziente. Chiudere la fibbia a sgancio rapido. Si dovrà udire il suono "di aggancio". Tirare bene le cinghie per garantire un buon fissaggio (Fig. 4).

APPLICAZIONE DEI BRACCIALI: (ripetere i passaggi 1-4 per ciascun lato):

1. Avvolgere la parte in neoprene attorno al polso/alla caviglia, in modo tale che la fibbia e la cinghia di connessione si trovino sul lato ulnare del polso o sul malleolo laterale della caviglia. Unire le parti in velcro nere e tirare indietro la linguetta nera sulla parte lanuginosa blu o rossa, quindi chiudere le parti in velcro blu o rosse. La parte lanuginosa deve essere inserita tra le due parti del gancio (Fig. 5). Sovraporre per almeno 3 cm (1 pollice).

2. Unire saldamente la chiusura in velcro e assicurarsi che aderisca in modo stabile. Infilare UN dito (piatto) tra il bracciale e la parte interna del polso/della caviglia del paziente per verificare che la misura sia corretta (Fig. 6).



2790



2790Q

BRACCIALI POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Cinghia doppia, misura standard/blu

REF 2790Q Cinghia doppia con fibbia a sgancio rapido, misura standard/blu

3. **2790:** far passare l'estremità della cinghia degli arti sopra la parte superiore del bracciale e inserirla nei due anelli a D sul bracciale. Portare di nuovo la cinghia sopra al primo anello e inserirla nei due anelli a D sul bracciale. Infilare un dito (piatto) tra il bracciale e la cinghia.

2790Q: chiudere la fibbia a sgancio rapido sul bracciale. Inserire UN dito (piatto) al di sotto della fibbia e stringere bene la cinghia, ma non tanto da limitare la circolazione del sangue (Fig. 7). Aprire la fibbia a sgancio rapido, ruotarla di 180° e collegarla nuovamente (Fig. 8). Si dovrà udire il suono "di aggancio".

4. Regolare la lunghezza della/e cinghia/e di connessione dal telaio, in modo da consentire la libertà di movimento desiderata, senza compromettere la sicurezza del paziente o del caregiver. Verificare che la/e estremità restante/i della cinghia siano fissate e lontane dalla portata del paziente.

PRECAUZIONI:

- È necessario eseguire una valutazione clinica per decidere se utilizzare il dispositivo insieme alle linee di monitoraggio o nel caso in cui il paziente abbia un arto ferito o lussato/fratturato.
- Controllare regolarmente il paziente per verificare che la circolazione del sangue non sia compromessa. Possono verificarsi lesioni gravi se i bracciali limitano la circolazione del sangue quando viene applicato il supporto per l'arto.
- Prima di ogni utilizzo, controllare che i bracciali e le cinghie non presentino crepe, strappi e/o segni di usura o allentamento eccessivo, che le fibbie o le serrature non siano rotte e/o che il velcro aderisca in maniera sicura. In caso contrario il paziente potrebbe riuscire a rimuovere il bracciale. Gettare via il dispositivo se è danneggiato o se è impossibile chiuderlo.
- AVVERTENZA:** potrebbe essere necessario utilizzare strumenti di contenzione aggiuntivi o diversi per gli arti o il corpo (visitare tidiproducts.com):
 - se il paziente tira violentemente le cinghie del letto;
 - per ridurre il rischio che il paziente abbia accesso alla sede di linee venose, ferite o tubi;
 - per evitare che il paziente si agiti o sobbalzi causando lesioni a sé stesso.

SICUREZZA DEL LETTO:

Fare riferimento alla Food and Drug Administration (FDA) o ad altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti per le più recenti linee guida sulla sicurezza dei letti ospedalieri e le istruzioni per l'uso del fabbricante del letto.

IT

Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. | Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili sul sito www.tidiproducts.com/IFU.

ULTERIORI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA E IL LAVAGGIO SONO DISPONIBILI SUL RETRO.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefono: 1.800.447.6739 • Internazionale: +1.920.751.4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tutti i diritti riservati.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germania

UK Persona responsabile
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Regno Unito

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



Posey® Twice-As-Tough® manchetten 2790, 2790Q

Instructies voor het aanbrengen op de pols en enkel



Uitsluitend op voorschrift.

PRODUCTOMSCHRIJVING: gevoerde hulpmiddelen voor immobilisatie van ledematen met dubbel beveiligde sluiting. Uitsluitend voor gebruik met een bed of stretcher.

BESTEMD GEBRUIK:

- Patiënten die volgens beoordeling risico lopen op verstoring van levensreddende behandeling (bijv. chronisch lostrekken van slangen) of bij wie het risico bestaat dat ze zichzelf of anderen verwonden.
- Volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis inzake immobilisatie die voldoen aan de Amerikaanse CMS-richtlijnen en staatswetten of aan die van andere regelgevende instanties buiten de VS.

CONTRA-INDICATIES:

Gebruik dit hulpmiddel niet bij iemand die voortdurend zeer agressief, ruziezoekend of zelfdestructief gedrag vertoont of iemand die als onmiddellijk risico voor zichzelf of anderen wordt beschouwd. Artsen moeten naast het immobilisatiehulpmiddel mogelijk aanvullende interventies uitvoeren.

GEBRUIKSINSTRUCTIES:

Gebruik methode a. of b. hieronder om riempjes aan het frame te bevestigen (stap 1 t/m 2 aan beide kanten uitvoeren):

1a. Driehoeksmethode om het bewegingsbereik van de patiënt te beperken: maak de riempjes los van elkaar en bevestig deze op verschillende punten aan het frame dat met de patiënt meebeekt (afb. 1) buiten bereik van de patiënt (niet bevestigen aan de zijklatten of het hoofd-/ voeteneinde) (afb. 2).

1b. Het bewegingsbereik van de patiënt vergroten: voeg de riempjes samen en bevestig deze aan één punt aan het frame dat met het patiënt meebeekt, buiten bereik van de patiënt.

2. **2790:** wikkel het verbindingsriempje om het frame door het riempje terug te halen tussen de eerste en tweede D-ring (afb. 3).


2790Q: wikkel het verbindingsriempje eenmaal om het frame dat met de patiënt meebeekt, buiten bereik van de patiënt. Sluit de snelontkoppelingsgesp. Luister of u een klik hoort. Trek stevig aan de riempjes om te verzekeren dat deze goed vastzitten (afb. 4).

AANBRENGEN VAN DE MANCHETTEN:

(stap 1 t/m 4 aan beide kanten uitvoeren):

1. Wikkel het neopreenstuk om de enkel/pols zodat de gesp en het verbindingsriempje zich aan de zijde van de ulna van de pols bevindt of aan de zijde van de malleolus lateralis van de enkel. Bevestig de zwarte stukken klittenband op elkaar en trek aan het zwarte trekklijpje op het blauwe of rode pluizige stuk, en bevestig daarna de blauwe of rode stukken klittenband op elkaar. Het pluizige stuk moet tussen de twee klittenbandgedeelten komen te liggen (afb. 5). Zorg dat de stukken ten minste 3 centimeter (1 inch) overlappen.

2. Druk de klittenbandsluiting stevig aan en controleer of deze goed blijft zitten. Schuif EEN vinger (plat) tussen de manchet en de binnenzijde van de enkel/pols van de patiënt om te verzekeren dat de manchet goed past. Afb. 6

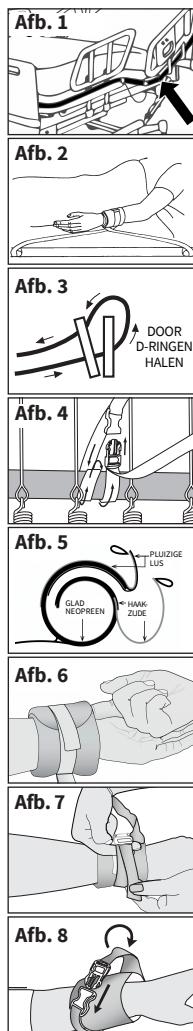

TWICE-AS-TOUGH MANCHETTEN VAN POSEY:

REF 2790 Dubbel riempje, reguliere maat/blauw

REF 2790Q Dubbel riempje met snelontkoppelingsgespen – reguliere maat/blauw

3. **2790:** voer het uiteinde van het riempje voor ledematen over de bovenkant van de manchet heen en door de twee D-ringen op de manchet. Haal het riempje terug over de eerste ring en door de twee D-ringen op de manchet. Schuif een vinger plat tussen de manchet en het riempje.

2790Q: sluit de snelontkoppelingsgesp op de manchet. Steek EEN vinger (plat) onder de gesp en trek het riempje strak, maar niet zo strak dat de bloedsomloop wordt belemmerd (afb. 7). Maak de snelontkoppelingsgesp los, draai de gesp 180°, en sluit deze opnieuw (afb. 8). Luister of u een klik hoort.

4. Pas de lengte van het/de verbindingsriempje(s) vanaf het frame aan zodat de gewenste bewegingsvrijheid wordt verkregen zonder dat dit de veiligheid van de patiënt of zorgverlener in gevaar brengt. Zorg dat het/de resterende riemuiteinde(n) buiten bereik van de patiënt wordt/worden vastgezet.

VOORZORGSMATREGELLEN:

- Een klinische beoordeling en beslissing zijn vereist wanneer het hulpmiddel wordt gebruikt met bewakingslijnen of als de patiënt een wond of een ontwrichte/gebroken ledemaat heeft.
- Controleer de patiënt regelmatig om te verzekeren dat de bloedsomloop niet wordt belemmerd. Als de ledemaathouder wordt gebruikt en de bloedsomloop door de manchetten wordt belemmerd, kan dat ernstig letsel veroorzaken.
- Inspecteer de manchetten en riempjes voor elk gebruik op barsten, scheuren en/of overmatige slijtage of uitrekken, op kapotte gespen of sloten, en/of controleer of de klittenbandsluitingen goed blijven zitten, omdat de patiënt de manchet anders zou kunnen verwijderen. Voer het hulpmiddel af als het is beschadigd of niet kan worden gesloten.
- WAARSCHUWING:** Mogelijk zijn aanvullende of andere hulpmiddelen voor immobilisatie van lichaam of ledematen vereist (ga naar [tidiproducts.com](http://www.tidiproducts.com)):
 - Als de patiënt hard aan de bedriempjes trekt.
 - Om te helpen voorkomen dat de patiënt bij de plaats van de lijn/wond/tube kan komen.
 - Om te voorkomen dat de patiënt om zich heen slaat of onbeheerst omhoog en omlaag beweegt en zich hierdoor verwondt.

BEDVEILIGHEID:

Raadpleeg de Food and Drug Administration (FDA), of andere regelgevende instanties buiten de VS, voor de meest recente richtlijnen voor de veiligheid van ziekenhuisbedden en de gebruiksinstructies van de fabrikant van het bed.

NL

Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. | Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op www.tidiproducts.com/IFU.

ZIE OMMEZIJDE VOOR AANVULLENDE VEILIGHEIDS- EN WASINSTRUCTIES.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 VS
Telefoon: 1.800.447.6739 • Internationaal: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Alle rechten voorbehouden.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Duitsland

UK Verantwoordelijke persoon
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Verenigd Koninkrijk

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



Imobilizadores Posey® Twice-As-Tough® 2790, 2790Q

Instruções de aplicação no pulso e no tornozelo



Posey®

Sujeito a prescrição

Descrição do Produto: Imobilizadores de membros almofadados com fecho de segurança dupla. Para utilização em camas e macas apenas.

USO PRETENDIDO:

- Doentes cuja avaliação revela risco de perturbação de tratamentos que salvam a vida (p. ex. puxar tubos continuamente) ou perigo de lesões nos próprios ou noutras pessoas.
- Siga as políticas e os procedimentos de imobilização do seu hospital que estejam em conformidade com as orientações dos CMS e a legislação estatal nos EUA, ou outras agências reguladoras fora dos EUA.

CONTRAINDICAÇÕES:

Não utilize este dispositivo em alguém que apresenta continuamente um comportamento altamente agressivo ou combativo, comportamento autodestrutivo ou que se considere representar um risco imediato para outras pessoas ou para o próprio. Os médicos poderão ter de utilizar intervenções adicionais juntamente com imobilizadores.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO:

Utilize o método a. ou b. abaixo para fixar as cintas à estrutura (repita os passos 1-2 em cada lado):

1a. Processo de triangulação; para restringir a amplitude do movimento do doente: separe as cintas e fixe em diferentes pontos ao longo da estrutura que se move com o doente (Fig. 1), fora do alcance do doente (não fixe à guarda lateral nem ao painel da cabeça ou dos pés) (Fig. 2).

1b. Para aumentar a amplitude do movimento do doente: coloque as cintas juntas e fixe num único ponto ao longo de uma parte da estrutura que se move com o doente, fora do alcance do doente.

2. **2790:** Enrole a cinta de conexão à estrutura puxando a cinta, para trás, entre o primeiro e o segundo anel em D (Fig. 3).







2790Q: Enrole a cinta de conexão uma vez em torno da estrutura que se move com o doente, fora do alcance do doente. Feche a fivela de abertura rápida. Preste atenção a um som de "encaixe". Puxe com firmeza as cintas para assegurar uma boa conexão (Fig. 4).

APLICAR OS IMOBILIZADORES:

(Repita os passos 1-4 para cada lado):

1. Enrole a peça de neopreno em torno do pulso/tornozelo de forma a que a fivela e a cinta de conexão estejam sobre o lado cubital do pulso ou sobre o maléolo lateral do tornozelo. Junte as peças de velcro negras e puxe a aba negra na peça de pelo azul ou vermelha, seguido das peças de velcro azuis ou vermelhas. A peça de pelo deve ficar entre as duas peças de velcro (Fig. 5). Certifique-se de sobrepor pelo menos 3 cm (uma polegada).

2. Pressione o fecho de velcro com firmeza e certifique-se de que o mesmo adere firmemente. Deslize UM dedo (esticado) entre o imobilizador e a parte interna do pulso/tornozelo do doente para garantir que está corretamente ajustado. (Fig. 6)



2790



2790Q

IMOBILIZADORES POSEY TWICE-AS-TOUGH:

REF 2790 Cinta dupla, tamanho regular/azul

REF 2790Q Cinta dupla com fivelas de abertura rápida, tamanho regular/azul

3. **2790:** Passe a extremidade da cinta do membro por cima do imobilizador e através dos dois anéis em D no imobilizador. Coloque a cinta para trás, sobre o primeiro anel e através dos dois anéis em D no imobilizador. Deslize um dedo esticado entre o imobilizador e a cintas.

2790Q: Feche a fivela de abertura rápida no imobilizador. Insira UM dedo (esticado) sob a fivela e puxe a cinta até ficar ajustada, mas não demasiado apertada ao ponto de restringir a circulação (Fig. 7). Liberte a fivela de abertura rápida, rode a fivela 180° e volte a conectar (Fig. 8). Preste atenção a um som de "encaixe".

4. Ajuste o comprimento da(s) tira(s) de conexão desde a estrutura para permitir a liberdade de movimento pretendida, sem comprometer a segurança do doente ou do cuidador. Assegure-se de que a(s) extremidade(s) das cintas remanescentes estão fixas fora do alcance do doente.

PRECAUÇÕES:

- São necessárias uma avaliação e uma decisão clínicas ao utilizar com linhas de monitorização ou se o doente tiver um membro com luxação/fratura.
- Avalie o doente regularmente para assegurar-se de que a circulação não é comprometida. Poderá ocorrer uma lesão grave se os imobilizadores restringirem a circulação ao aplicar imobilização de membros.
- Antes de cada utilização, verifique os imobilizadores e as cintas quanto à presença de fissuras, rasgões, estiramento ou desgaste excessivo, fivelas ou fechaduras partidas, e/ou que o velcro adere com segurança, pois tal poderá permitir que o doente remova o imobilizador. Elimine o dispositivo se o mesmo estiver danificado ou se não for possível fechá-lo.
- ADVERTÊNCIA:** Poderão ser necessários imobilizadores do corpo ou dos membros adicionais ou diferentes (visite tidiproducts.com):
 - Se o doente puxar violentamente as cintas da cama.
 - Para reduzir o risco de o doente conseguir ter acesso ao local das linhas/feridas/tubos.
 - Para evitar que o doente se agite ou sacuda de um lado para o outro e se lesione.

SEGURANÇA DAS CAMAS:

Consulte a Food and Drug Administration (FDA), ou outras agências reguladoras fora dos EUA, para obter as mais recentes orientações sobre segurança de camas hospitalares, bem como as instruções de utilização do fabricante das camas.

PT

Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. | Traduções deste documento em francês, espanhol, holandês, alemão, italiano e português encontram-se em www.tidiproducts.com/IFU.

INSTRUÇÕES ADICIONAIS DE SEGURANÇA E LAVAGEM NO VERSO.

TIDI

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EUA
Telefone: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Todos os direitos reservados.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha

UK
CA
UK Pessoa responsável
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19253 REV C 2021-07-16



Safety Information for the use of Posey® Restraining Products



Posey®


For RX PRODUCTS ONLY. Federal law (USA) restricts this device to sale by or on order of a physician. For use in a licensed healthcare facility only.

STAFF TRAINING: Tidi offers inservice training aids at no charge. Contact Tidi online at www.tidiproducts.com or call toll-free at 1.800.447.6739.

BEFORE APPLYING ANY RESTRAINT: Follow your hospital's restraint policies and procedures which are in compliance with USA CMS guidelines and state laws or other governing agencies outside the USA.

ADDITIONAL WARNINGS:

1. ALWAYS monitor patient per facility policy. Improper application or use of any restraint may result in serious injury or death. Be aware that constant monitoring may be required for:
 - Aggressive or agitated patients; and
 - Patients in a supine position; ensure that being in this position would not cause any complications for those who are at risk of vomiting while being restrained.
2. NEVER alter or repair this product. ALWAYS Inspect before each use: Check for broken stitches or parts; torn, cut or frayed material; or locks, buckles, or hook-and-loop fasteners that do not hold securely. DO NOT use soiled or damaged products. Doing so may result in serious injury or death. Dispose of damaged products per facility policy for BIOHAZARDOUS material.
3. ALWAYS secure straps to a part of the frame that moves with the patient (not foot/head board or siderails), out of the patient's reach, using quick-release ties (see drawing below) or buckles. These allow easy release in the event of an accident or fire.
Test to make sure straps cannot tighten, loosen, or slip and create excess slack. If this occurs, the patient may slide off the chair or bed, increasing the risk of serious injury or suffocation. Restraint release is an important part of facility fire and disaster drills. Straps can be cut with scissors in an emergency.
4. NEVER secure restraint strap to side rail or head/foot board.
5. NEVER use Posey products on toilets, or on any chair or furniture that does not allow proper application as directed in the Application Instructions. DO NOT use at home.
6. NEVER expose this product to open flame, fire, smoking materials, or high heat sources. Some products may melt or ignite and burn. The facility smoking/no smoking policy should be strictly enforced.
7. NEVER use a Posey product as a seat belt in a moving vehicle. Posey products are not designed to withstand the force of a crash or sudden stop.
8. Test Zippers or hook-and-loop fasteners before each use. DISCARD device if it does not fasten securely.



LAUNDERING INSTRUCTIONS (if applicable):

- Fasten all buckles and locks to reduce risk of damage during wash and dry cycles. DO NOT put buckles or locks through extractors. For maximum life, launder in a laundry bag.
- Stainless Steel Locks: Posey recommends that locks be treated with a dryfilm lubricant (silicone) after each cleaning. For best results, spray a small amount into the lock. Work the action of the lock with a key several times to ensure that all the surfaces are well lubricated.
- Before laundering, zip up and turn the product inside out to protect zipper.
- Hook-and-loop fasteners may collect lint after repeated use or laundering, reducing grip strength. Fasten the "hook" to the "loop" before laundering to help prevent lint buildup. As needed, use a stiff-bristle brush to remove lint from the "hook" side.
- These products, other than foam products, can be machine washed under CDC* guidelines for material soiled with blood or bodily fluid.

	160°F 71°C		BLEACH AS DIRECTED ON CONTAINER		DRY ON LOW
--	---------------	--	---------------------------------	--	------------
- For non-contaminated material, use lower temperature wash and dry cycles to extend product life.
- For foam products:


	100°F 38°C		BLEACH AS DIRECTED ON CONTAINER		DRY ON LOW
--	---------------	--	---------------------------------	--	------------
- Make sure products are completely dry before use.

STORAGE AND HANDLING:

- This device is designed for use in normal indoor environments.
- This device may be stored in ambient warehouse temperatures at normal humidity levels. Avoid excess moisture or high humidity that may damage product materials.

*www.cdc.gov

HOW TO TIE THE POSEY QUICK-RELEASE TIE

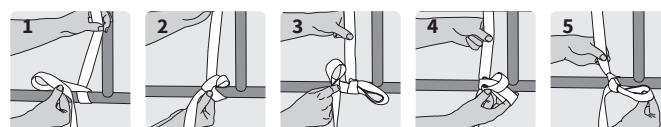

1. Wrap strap once around the frame that moves with the patient (do not attach to side rail or head/footboard), leaving at least an 8" (20 cm) tail. Fold the loose end in half to create a loop and cross it over the other end.
2. Insert the folded strap where the straps cross over each other, as if tying a shoelace. Pull on the loop to tighten.
3. Fold the loose end in half to create a second loop.
4. Insert the second loop into the first loop.
5. Pull on the loop to tighten. Test to make sure strap is secure and will not slide in any direction.
6. Repeat on other side. Practice quick-release ties to ensure the knot releases with one pull on the loose end of the strap.

EN

Report any serious incident related to device use to TIDI Products and the Member State Competent Authority. | Translations of this document in French, Spanish, Dutch, German, Italian, and Portuguese are located at www.tidiproducts.com/IFU.

DISPOSAL: Dispose of product according to facility guidelines or after thirty-day use or sooner if product is worn or damaged.

TIDI

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Phone: 1.800.447.6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. All rights reserved.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover, Germany



UK Responsible Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
United Kingdom

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
I9200B REV E 2021-05-14



Sicherheitshinweise für die Verwendung von Posey® Rückhalteprodukten



Posey®


NUR für PRODUKTE MIT RX-KENNZEICHNUNG. Dieses Produkt ist auf den Verkauf durch oder im Auftrag eines Arztes durch das Bundesgesetz (USA) beschränkt. Nur zur Verwendung in einer lizenzierten Gesundheitseinrichtung.

PERSONALSCHULUNG: Tidi bietet kostenlose Schulungshilfen an. Kontaktieren Sie Tidi online unter www.tidiproducts.com oder rufen Sie in den USA gebührenfrei unter 1.800.447.6739 an.

VOR DEM ANLEGEN JEGLICHER RÜCKHALTEVORRICHTUNGEN: Befolgen Sie die Vorschriften und Verfahren für Rückhaltevorrichtungen Ihres Krankenhauses in Übereinstimmung mit den US-amerikanischen CMS-Richtlinien und den Gesetzen der Bundesstaaten oder anderen behördlichen Richtlinien außerhalb der USA.

⚠ ZUSÄTZLICHE WARNHINWEISE:

- Den Patienten IMMER gemäß den Richtlinien der Einrichtung überwachen. Eine unsachgemäße Anwendung oder Handhabung kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Beachten Sie, in den folgenden Fällen eine ständige Überwachung erforderlich sein kann:
 - Patienten, die aggressiv oder unruhig sind; und
 - Patienten, die sich in Rückenlage befinden. Vergewissern Sie sich, dass bei Patienten in dieser Position im Falle von Erbrechen während der Fixierung keine Komplikationen auftreten können.
- Ändern oder reparieren Sie dieses Produkt NIEMALS. IMMER vor jedem Gebrauch prüfen: Vergewissern Sie sich, dass keine Nähte oder Teile beschädigt sind, das Material nicht gerissen, angeschnitten oder ausgefranst ist und dass alle Schlosser, Schnallen oder Klettverschlüsse sicher halten. Verwenden Sie KEINE verschmutzten oder beschädigten Produkte. Andernfalls kann es zu schweren Verletzungen oder zum Tod kommen. Entsorgen Sie beschädigte Produkte gemäß den Richtlinien für BIOLOGISCH GEFÄHRLICHES Material.
- Sichern Sie die Gurte IMMER außerhalb der Reichweite des Patienten mithilfe der Schnellverschluss-Schlaufen (siehe Abbildung unten) an einem Teil des Bettrahmens, der mit dem Patienten bewegt wird (nicht am Fuß-/Kopfteil oder an den Seitenleisten). Der Schnellverschluss ermöglicht ein leichtes Lösen im Falle eines Unfalls oder Brandes. Überprüfen Sie, dass die Gurte sich nicht festziehen, lösen oder verrutschen und dass sie nicht übermäßig locker sind. In diesem Fall kann der Patient vom Stuhl oder Bett rutschen, was das Risiko schwerer Verletzungen oder Erstickungen erhöht. Das Lösen von Rückhaltevorrichtungen ist ein wichtiger Bestandteil von Brand- und Katastrophenübungen. Die Gurte können im Notfall mit einer Schere durchgeschnitten werden.
- Befestigen Sie einen Rückhaltegurt NIEMALS an einer Seitenleiste oder am Fuß-/Kopfteil.
- Verwenden Sie Posey-Produkte NIEMALS auf Toiletten, Stühlen oder Möbeln, die eine ordnungsgemäße Anwendung gemäß den Anweisungen in der Anwendungsanleitung nicht zulassen. NICHT zu Hause verwenden.
- Setzen Sie dieses Produkt NIEMALS offenen Flammen, Feuer, rauchenden Materialien oder starken Hitzequellen aus. Einige Produkte können schmelzen oder sich entzünden und verbrennen. Die Raucher-/Nichtraucherpolitik Ihrer Einrichtung sollte strikt eingehalten werden.
- Ein Posey Produkt darf NIEMALS als Sicherheitsgurt in einem fahrenden Fahrzeug verwendet werden. Posey Produkte sind nicht dafür konzipiert, der Kraft eines Crashes oder plötzlichen Stopps standzuhalten.
- Testen Sie Reißverschlüsse oder Klettverschlüsse vor jedem Gebrauch. ENTSORGEN Sie das Produkt, wenn es nicht sicher befestigt werden kann.



ANLEITUNG ZUM WASCHEN (falls zutreffend):

- Schließen Sie alle Schnallen und Schlosser, um das Risiko einer Beschädigung während des Wasch- und Trockenvorgangs zu verringern. KEINE Schnallen oder Schlosser durch Extraktoren stecken. Für maximale Lebensdauer in einem Wäschesack waschen.
- Edelstahl-Schlosser: Posey empfiehlt, die Schlosser nach jeder Reinigung mit einem Trockenschmiermittel (Silikon) zu behandeln. Sprühen Sie eine kleine Menge des Schmiermittels in das Schloss, um das beste Ergebnis zu erzielen. Betätigen Sie den Schließmechanismus des Schlosses mehrere Male mit dem Schlüssel, um sicherzustellen, dass alle Oberflächen gut abgeschmiert sind.
- Vor dem Waschen sollten Sie den Reißverschluss hochziehen und das Produkt von innen nach außen drehen, um den Reißverschluss zu schützen.
- Klettverschlüsse können nach mehrmaligem Gebrauch oder Waschen Fusseln aufnehmen und so die Grifffestigkeit verringern. Befestigen Sie den „Haken“ vor dem Waschen an der „Schlaufe“, um Fusselbildung zu vermeiden. Bei Bedarf Fusseln von der „Hakenseite“ mithilfe einer Bürste mit harten Borsten entfernen.

Diese Produkte, mit Ausnahme von Schaumstoffprodukten, können nach den CDC*-Richtlinien für mit Blut oder Körperflüssigkeit verschmutztes Material in der Waschmaschine gewaschen werden.

160°F
71°C
25 MIN. HEISS
WASCHEN
GEMÄSS VORSCHRIFT
AUF DEM BEHÄLTER
BLEICHEN
AUF NIEDRIGER
STUFE TROCKEN

- Für nicht kontaminiertes Material verwenden Sie Wasch- und Trockenzyklen bei niedrigerer Temperatur, um die Lebensdauer des Produkts zu verlängern.

- Für Schaumstoffprodukte:

100°F
38°C
LAUWARM
WASCHEN
GEMÄSS VORSCHRIFT
AUF DEM BEHÄLTER
BLEICHEN
AUF NIEDRIGER
STUFE TROCKEN


- Stellen Sie sicher, dass die Produkte vor der Verwendung vollständig trocken sind.

LAGERUNG UND HANDHABUNG:

- Dieses Produkt ist für den Einsatz in normalen Innenräumen konzipiert.
- Dieses Produkt kann bei Raumtemperatur und normaler Luftfeuchtigkeit gelagert werden. Das Produkt vor übermäßiger Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit schützen, da es dadurch beschädigt werden kann.

*www.cdc.gov

SO BINDEN SIE DIE POSEY SCHNELLVERSCHLUSS-SCHLAUFE

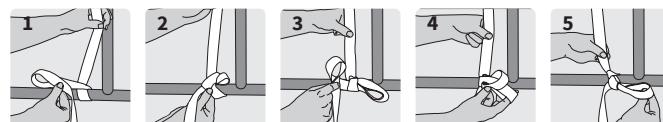

- Wickeln Sie den Gurt einmal um den Bettrahmen, der mit dem Patienten bewegt wird (nicht an Seitenschiene oder Kopf-/Fußende befestigen), und lassen Sie dabei mindestens ein 20 cm langes Endstück zurück. Falten Sie das lose Ende in der Mitte, um eine Schlaufe zu bilden, und kreuzen Sie es über das andere Ende.
- Legen Sie den gefalteten Gurt dort ein, wo sich die Bänder kreuzen, als ob Sie einen Schnürsenkel binden würden. Zum Festziehen an der Schlaufe ziehen.
- Falten Sie das lose Ende in der Mitte, um eine zweite Schlaufe zu bilden.
- Fügen Sie die zweite Schleife in die erste Schleife ein.
- Zum Festziehen an der Schlaufe ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Gurt fest sitzt und in keine Richtung verrutschen kann.
- Wiederholen Sie dies auf der anderen Seite. Über Sie das schnelle Öffnen, um sicherzustellen, dass sich der Knoten mit einem Zug am losen Ende des Riems löst.

DE

Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall im Zusammenhang mit der Verwendung der Vorrichtung an TIDI Products sowie an die zuständige Behörde des Mitgliedsstaates. | Übersetzungen dieses Dokuments in die Sprachen Französisch, Spanisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch und Portugiesisch finden Sie auf www.tidiproducts.com/IFU.

ENTSORGUNG: Entsorgen Sie das Produkt gemäß den Vorschriften der Einrichtung oder nach dreißig Tagen der Verwendung bzw. früher, falls das Produkt verschlossen oder beschädigt ist.

CA

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefon: +1 800 447 6739 • International: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Alle Rechte vorbehalten.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Deutschland

UK
CA
UK Verantwortliche Person
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Vereinigtes Königreich

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19200B REV E 2021-05-14



Información de seguridad para el uso de los productos de sujeción de Posey®



Posey®


ÚNICAMENTE PARA PRODUCTOS DE VENTA CON RECETA MÉDICA. La legislación federal de EE. UU. autoriza la venta exclusivamente a médicos o por orden de estos. Para uso exclusivo en centros sanitarios autorizados.

FORMACIÓN DEL PERSONAL: Tidi ofrece ayuda formativa interna de forma gratuita. Póngase en contacto con Tidi a través de www.tidiproducts.com o llame al número gratuito 1.800.447.6739.

ANTES DE APLICAR LAS SUJECIONES: siga las políticas y procedimientos de sujeción de su hospital que cumplan con las directrices de los CMS de EE. UU. y las leyes estatales u otras agencias gubernamentales fuera de los EE. UU.

⚠️ ADVERTENCIAS ADICIONALES:

- Supervise SIEMPRE al paciente según la política del centro. Una aplicación o uso inadecuados de una sujeción puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Tenga en cuenta que se requerirá una supervisión constante para:
 - pacientes agresivos o inquietos, y
 - pacientes en decúbito supino (asegúrese de que esta posición no provoque ninguna complicación para aquellas personas en riesgo de vomitar mientras estén sujetas).
- NUNCA altere ni repare este producto. Inspecciónelo SIEMPRE antes de cada uso: busque costuras o partes rotas, material rasgado, cortado o deshilachado y compruebe si los bloqueos, hebillas o cierres de velcro no sujetan firmemente. NO use productos dañados o sucios. Hacerlo puede provocar lesiones graves e incluso la muerte. Elimine el producto según las políticas del centro sobre materiales CON RIESGO BIOLÓGICO.
- SIEMPRE fije las correas a una parte del marco que se mueva con el paciente (no al cabecero, el estribo o los laterales), fuera del alcance de los pacientes y usando bridas o hebillas de liberación rápida (consulte la imagen a continuación). De esta forma se pueden liberar rápidamente en caso de accidente o incendio. Pruébelas para asegurarse de que las correas no se pueden apretar, aflojar o resbalar y que no se pueda crear holgura excesiva. Si esto ocurre, el paciente podrá deslizarse de la silla o la cama, lo que aumenta el riesgo de lesión grave o asfixia. La liberación de la sujeción es una parte importante de los simulacros de incendios y catástrofes de los centros. Las correas se pueden cortar con tijeras en caso de emergencia.
- NNUNCA fije una correa de sujeción a un lateral o al cabecero o estribo de la cama.
- NUNCA use los productos de Posey en inodoros, sillas o mobiliario que no permita una correcta aplicación como se indica en las instrucciones de aplicación. NO use el producto en casa.
- NUNCA exponga el producto a llamas abiertas, fuego, materiales húmedos o fuentes de calor. Algunos productos pueden derretirse o prenderse y quemarse. Se deberá aplicar estrictamente la política relativa a la prohibición de fumar del centro.
- NUNCA use un producto de Posey como cinturón de seguridad en un vehículo en movimiento. Los productos de Posey no están diseñados para resistir la fuerza de una colisión o una parada repentina.
- Pruebe las cremalleras y los cierres de velcro antes de cada uso. ELIMINE el producto si no se sujeta firmemente.



INSTRUCCIONES DE LAVADO (cuando proceda):

- Sujete todas las hebillas y bloqueos para reducir el riesgo de daño durante los ciclos de lavado y secado. NO pase las hebillas ni los bloqueos por extractores. Para una máxima vida útil, lave los productos en una bolsa para lavado.
- Bloques de acero inoxidable: Posey recomienda tratar los bloques con un lubricante de película seca (silicona) tras cada lavado. Para obtener un resultado óptimo, pulverice una pequeña cantidad en el bloqueo. Haga funcionar el mecanismo del bloqueo con una llave varias veces para asegurarse de que todas las superficies estén lubricadas.
- Antes de lavarlo, cierre la cremallera y ponga el producto del revés para protegerla.
- Es posible que los cierres de velcro acumulen pelusa tras un uso repetido o el lavado, lo que reduce la fuerza de agarre. Ciérrellos antes de lavarlos para evitar la acumulación de pelusa. Si es necesario, use un cepillo de cerda dura para retirar la pelusa del velcro.

- Todos los productos que no sean de espuma se pueden lavar a máquina de acuerdo con las pautas de los CDC* sobre material manchado de sangre o líquidos corporales.

180°F
82°C
LAVAR EN AGUA CALIENTE 25 MIN.
LEJÍA SEGÚN SE INDICA EN EL ENVASE
SECAR A BAJA TEMP.

- En el caso de los materiales no contaminados, ponga ciclos de lavado y secado a una temperatura menor para ampliar la vida útil del producto.

- Para productos de espuma:

100°F
38°C
LAVAR EN AGUA TIBIA
LEJÍA SEGÚN SE INDICA EN EL ENVASE
SECAR A BAJA TEMP.


- Asegúrese de que los productos estén completamente secos antes de su uso.

ALMACENAMIENTO Y MANIPULACIÓN:

- Este producto está diseñado para su uso en entornos interiores normales.
- Este producto puede almacenarse a temperatura ambiente de almacén a niveles de humedad normales. Evite el exceso de humedad o alta humedad que pueda dañar los materiales del producto.

*www.cdc.gov

CÓMO ATAR LA BRIDA DE LIBERACIÓN RÁPIDA DE POSEY

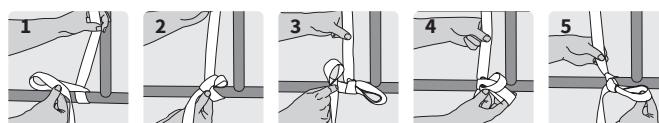

- Enrolle la correa una vez alrededor del marco que se mueve con el paciente (no la sujeté a los laterales ni al cabecero o al estribo de la cama). Deje un extremo suelto de unos 20 cm como mínimo. Pliegue por la mitad el extremo suelto para crear un lazo y crícelo por el otro extremo.
- Inserte la correa plegada donde las correas se cruzan entre sí, como si atara los cordones de unos zapatos. Tire del lazo para tensarlo.
- Pliegue por la mitad el extremo suelto para crear un segundo lazo.
- Inserte el segundo lazo en el primer lazo.
- Tire del lazo para tensarlo. Pruébelo para asegurarse de que la correa esté fija y no se resbale a ninguna dirección.
- Repita en el otro lado. Pruebe las bridas de liberación rápida para garantizar que el nudo se libere al tirar del extremo suelto de la correa.

ES

Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso del dispositivo a TIDI Products y a la autoridad competente del Estado miembro. | Las traducciones de este documento en francés, español, holandés, alemán, italiano y portugués se encuentran en www.tidiproducts.com/IFU.

ELIMINACIÓN: elimine el producto de acuerdo con las directrices del centro o tras 30 días de uso o antes si el producto está desgastado o dañado.

EN

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EE. UU.
Teléfono: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Reservados todos los derechos.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemania

UK Persona Responsable
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
I9200B REV E 2021-05-14



Informations relatives à la sécurité pour l'utilisation des produits de contention Posey®



Posey®


PRODUITS EXCLUSIVEMENT DÉLIVRÉS SUR PRESCRIPTION. La loi fédérale des États-Unis n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin. Exclusivement destiné à une utilisation dans un établissement de santé agréé.

FORMATION DU PERSONNEL: Tidi propose des aides gratuites à la formation en cours d'emploi. Veuillez contacter Tidi en ligne à l'adresse suivante: www.tidiproducts.com ou gratuitement par téléphone au numéro suivant: 1 800 447 6739.

AVANT D'APPLIQUER LA CONTENTION: Veuillez suivre les politiques et les procédures de contention de votre hôpital, en conformité avec les directives des Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS), les lois locales des États-Unis ou, en dehors des États-Unis, des autorités compétentes.

MISES EN GARDE SUPPLÉMENTAIRES:

1. TOUJOURS surveiller le patient conformément à la politique de l'établissement. L'application ou l'utilisation inappropriées d'un dispositif de contention peut entraîner des blessures graves, voire la mort. Une surveillance constante peut être nécessaire pour:
 - les patients agressifs ou agités, et
 - les patients en décubitus dorsal; veuillez vous assurer que cette position n'entraîne pas des complications chez les patients risquant de vomir pendant la contention.
2. NE JAMAIS altérer ou réparer ce produit. TOUJOURS l'inspecter avant son utilisation: déterminer si le produit comporte des coutures ou des pièces endommagées; du matériau déchiré, coupé ou effiloché; ou verrou, boucles ou attaches à boucles et à crochets qui ne s'attachent pas bien. NE PAS utiliser des produits souillés ou endommagés. Cela pourrait entraîner des blessures graves, voire la mort. Se débarrasser des produits endommagés conformément à la politique de l'établissement en matière de matériaux BIOLOGIQUEMENT DANGEREUX.
3. TOUJOURS attacher les sangles à une partie du cadre qui se déplace avec le patient (et non au pied ou à la tête de lit ou aux rails latéraux), hors de portée du patient, à l'aide d'attaches à dégagement rapide (voir dessin ci-dessous) ou de boucles. Celles-ci permettront une libération facile en cas d'accident ou d'incendie. Tester pour s'assurer que les sangles ne peuvent pas se serrer, se desserrer ou glisser et devenir trop lâches. Si cela se produit, le patient peut glisser de la chaise ou du lit, et risquer des blessures graves ou la suffocation. L'ouverture des dispositifs de contention est une partie importante des exercices de secours en cas d'incendie et de catastrophe. Les sangles peuvent être coupées avec des ciseaux en cas d'urgence.


4. NE JAMAIS fixer les sangles au rail latéral, à la tête ou au pied du lit.
5. NE JAMAIS utiliser de produits Posey sur des toilettes ou encore sur des sièges ou des meubles qui ne permettent pas leur application conformément aux instructions d'application. NE PAS utiliser à domicile.
6. NE JAMAIS exposer ce produit à une flamme nue, un feu, des matériaux en combustion ou des sources de chaleur élevée. Certains produits peuvent fondre ou s'enflammer et brûler. La politique de l'établissement en matière de tabagisme doit être strictement appliquée.
7. NE JAMAIS utiliser un produit Posey comme ceinture de sécurité dans un véhicule en mouvement. Les produits Posey ne sont pas conçus pour résister à la force d'un accident ou d'un arrêt soudain.
8. Tester les fermetures à glissière ou les attaches à boucles et à crochets avant chaque utilisation. JETER le dispositif s'il ne peut pas s'attacher solidement.

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE (le cas échéant):

- Attacher toutes les boucles et serrures pour réduire les risques de dommages pendant les cycles de lavage et de séchage. NE PAS mettre de boucles ou de verrous dans des extracteurs. Pour maximiser la durée de vie du produit, le laver dans un sac à linge.
- Serrures en acier inoxydable : Posey recommande de traiter les serrures avec un lubrifiant à film sec (silicone) après chaque nettoyage. Pour de meilleurs résultats, pulvériser une petite quantité dans la serrure. Faire fonctionner la serrure plusieurs fois avec une clé afin de s'assurer que toutes les surfaces ont bien été lubrifiées.
- Avant de laver le produit, le fermer et le retourner pour protéger la fermeture à glissière.
- Des peluches peuvent s'accumuler sur les attaches à boucles et crochets après un usage répété ou un lavage, réduisant ainsi la force de préhension. Attacher le « crochet » à la « boucle » avant le lavage pour éviter l'accumulation de peluches. Le cas échéant, utiliser une brosse à poils rigides pour retirer les peluches du côté « crochet ».

• Ces produits, à l'exception des produits en mousse, peuvent être lavés à la machine selon les directives du CDC* pour les produits souillés de sang ou de fluides corporels.



• Pour les matériaux non contaminés, utiliser des cycles de lavage et de séchage à basse température pour prolonger la durée de vie du produit.

• Pour les produits en mousse:




• Assurez-vous que les produits sont entièrement secs avant de les utiliser.

STOCKAGE ET MANIPULATION:

- Ce dispositif est conçu pour être utilisé dans des environnements d'intérieur normaux.
- Ce dispositif peut être stocké à des températures ambiantes à des niveaux d'humidité normaux. Éviter des environnements aux taux d'humidité élevés qui pourraient endommager les matériaux du produit.

*www.cdc.gov

COMMENT FIXER LES ATTACHES À DÉGAGEMENT RAPIDE POSEY

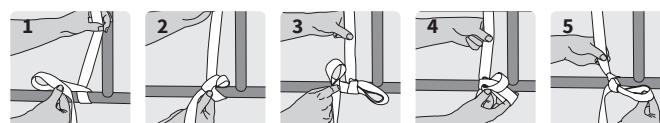

1. Enrouler une fois la sangle autour du cadre qui se déplace avec le patient (ne pas l'attacher au rail latéral ou à la tête/au pied de lit), en laissant au moins une longueur de 8 pouces (20 cm). Plier l'extrémité libre en deux pour créer une boucle et la croiser sur l'autre extrémité.
2. Insérer la sangle pliée à l'endroit où les sangles se croisent, comme pour attacher un lacet de chaussure. Tirer sur la boucle pour serrer.
3. Plier l'extrémité libre en deux pour créer une seconde boucle.
4. Insérer la seconde boucle dans la première boucle.
5. Tirer sur la boucle pour serrer. Tester pour s'assurer que la sangle est bien fixée et ne glissera dans aucune direction.
6. Répéter de l'autre côté. Tester les attaches à dégagement rapide pour s'assurer que le noeud se libère en tirant sur l'extrémité libre de la sangle.

FR

Signalez tout incident grave lié à l'utilisation de ce dispositif à TIDI Products et à l'autorité compétente de l'État membre. | Les traductions de ce document en allemand, espagnol, français, italien, néerlandais et portugais sont disponibles sur le site www.tidiproducts.com/IFU.

ÉLIMINATION: Éliminer le produit conformément aux directives de l'établissement ou après une utilisation de 30 jours ou moins si le produit est usé et endommagé.

EN

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Téléphone : +1 800 447 6739 • International : +1 920 751 4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tous droits réservés.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hanovre,
Allemagne
UK Responsible
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 - UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB24BZ
Royaume-Uni

UK
CA
TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19200B REV E 2021-05-14



Informazioni di sicurezza per l'uso dei prodotti di contenzione Posey®




SOLO PER PRODOTTI SU PRESCRIZIONE. La legge federale (USA) limita la vendita di questo dispositivo ai medici o su presentazione di richiesta medica. Esclusivamente per l'uso in una struttura sanitaria approvata.

FORMAZIONE DEL PERSONALE: Tidi offre servizi di formazione intraziendale gratuiti. Contattare Tidi online all'indirizzo www.tidiproducts.com o chiamare il numero verde (in USA) 1.800.447.6739.

PRIMA DI APPLICARE QUALSIASI MISURA DI CONTENZIONE: seguire le politiche e le procedure di contenzione dell'ospedale conformi alle linee guida dei CMS statunitensi e alle normative statali o di altri enti governativi al di fuori degli Stati Uniti.

⚠ ULTERIORI AVVERTENZE:

- Monitorare SEMPRE il paziente in conformità alle politiche della struttura. L'applicazione o l'uso errati di qualsiasi misura di contenzione possono causare lesioni gravi o la morte. Potrebbe essere necessario un monitoraggio costante per:
 - Pazienti aggressivi o agitati; e
 - Pazienti in posizione supina; assicurare che la posizione non cau si complicazioni a chi è a rischio di vomito durante la contenzione.
- Non modificare o riparare MAI questo prodotto. Ispezionare SEMPRE prima di ogni utilizzo: controllare che non siano presenti punti o parti rotti, materiale lacerato, tagliato o usurato oppure chiusure, fibbie e fissaggi con velcro che non bloccano in modo sicuro. NON utilizzare prodotti sporchi o danneggiati onde evitare di provocare lesioni gravi o la morte. Smaltire i prodotti danneggiati in conformità alle politiche della struttura per i materiali A RISCHIO BIOLOGICO.
- Fissare SEMPRE le cinghie a una parte del telaio che si muove con il paziente (non pediera/testiera o sponde laterali), al di fuori della portata del paziente, utilizzando legature a sgancio rapido (vedere il disegno di seguito) o fibbie che permettano un facile rilascio in caso di incidente o di incendio. Verificare che le cinghie non possano stringersi, allentarsi o scivolare creando un lasco eccessivo. In tal caso, il paziente potrebbe scivolare dalla sedia o dal letto, aumentando il rischio di lesioni gravi o soffocamento. Il rilascio della contenzione è una parte importante delle esercitazioni antincendio e anticalamità di una struttura. In caso di emergenza, le cinghie possono essere tagliate con le forbici.
- Non fissare MAI la cinghia di contenzione alle sponde laterali o alla testiera/pediera.
- Non utilizzare MAI i prodotti Posey su tazze del WC o su qualsiasi sedia o mobile che non permetta una corretta applicazione, descritta nelle istruzioni di applicazione. NON utilizzare a casa.
- Non esporre MAI il prodotto a fiamme aperte, fuoco, fumo o fonti di calore elevato. Alcuni prodotti possono fondersi o accendersi e bruciare. Rispettare rigorosamente le politiche di divieto del fumo della struttura.
- Non usare MAI un prodotto Posey come cintura di sicurezza in un veicolo in movimento. I prodotti Posey non sono progettati per sostenere la forza di un urto o di un arresto improvviso.
- Controllare le cerniere e i fissaggi con Velcro prima di ogni utilizzo. ELIMINARE il dispositivo se non permette un fissaggio sicuro.



ISTRUZIONI PER IL LAVAGGIO (se applicabile):

- Chiudere tutte le fibbie e le chiusure per ridurre il rischio di danni durante i cicli di lavaggio e di asciugatura. NON inserire le fibbie o le chiusure in estrattori. Per prolungare al massimo la durata, lavare in una sacca da lavanderia.
- Chiusure in acciaio inossidabile: Posey raccomanda di trattare le chiusure con un lubrificante che forma una pellicola asciutta (silicone) dopo ogni pulizia. Per risultati ottimali, spruzzarne una piccola quantità nella chiusura. Azionare la chiusura con una chiave più volte per assicurare che tutte le superfici siano ben lubrificate.
- Prima del lavaggio, chiudere le cerniere e rivoltare il prodotto per proteggerle.
- I fissaggi con Velcro possono raccogliere pelucchi dopo l'uso ripetuto o il lavaggio, riducendo la tenuta della chiusura. Prima del lavaggio, far aderire le due parti dei fissaggi con Velcro l'una all'altra per prevenire l'accumulo di pelucchi. Se necessario, utilizzare una spazzola rigida per rimuovere i pelucchi dal lato con i gancetti del fissaggio con Velcro.

- Questi prodotti, diversamente da quelli in schiuma, possono essere lavati in lavatrice seguendo le linee guida dei CDC* relative ai materiali sporchi di sangue o di liquidi corporei.



- Per i materiali non contaminati, utilizzare cicli di lavaggio e asciugatura a bassa temperatura per prolungare la vita del prodotto.

- Per i prodotti in schiuma:




- Verificare che i prodotti siano completamente asciutti prima dell'uso.

CONSERVAZIONE E MANIPOLAZIONE:

- Questo dispositivo è progettato per l'uso in normali ambienti al chiuso.
- Questo dispositivo può essere conservato alla temperatura ambiente di un deposito con livelli di umidità normali. Evitare di esporre a condizioni di umidità elevata o eccessiva, in quanto si rischia di danneggiare i materiali che compongono il prodotto.

*www.cdc.gov

COME REALIZZARE LA LEGATURA A SGANCI RAPIDO POSEY

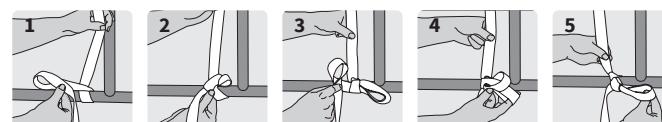

- Avvolgere la cinghia una volta intorno al telaio che si muove con il paziente (non fissare alle sponde laterali o alla testiera/pediera), lasciando una coda di almeno 20 cm. Piegare a metà l'estremità libera per creare un anello e farlo passare sull'altra estremità.
- Inserire la cinghia piegata nel punto in cui si intersecano le cinghie, come quando si allacciano le stringhe delle scarpe. Tirare l'anello per stringere.
- Piegare a metà l'estremità dell'anello per creare un secondo anello.
- Inserire il secondo anello nel primo.
- Tirare l'anello per stringere. Verificare che la cinghia sia fissata e non scorra in nessuna direzione.
- Ripetere sull'altro lato. Testare le legature a sgancio rapido per accertarsi che il nodo si apra tirando una volta l'estremità libera della cinghia.

IT

Segnalare eventuali incidenti gravi correlati all'uso del dispositivo a TIDI Products e all'autorità competente dello stato membro. | Le traduzioni del presente documento in francese, spagnolo, olandese, tedesco, italiano e portoghese sono disponibili sul sito www.tidiproducts.com/IFU.

SMALTIMENTO: smaltire il prodotto in conformità alle linee guida della struttura oppure dopo trenta giorni di utilizzo o meno nel caso in cui il prodotto sia usurato o danneggiato.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 USA
Telefono: 1.800.447.6739 • Internazionale: +1.920.751.4036
www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Tutti i diritti riservati.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Germania

UK Persona responsabile
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Regno Unito

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
19200B REV E 2021-05-14



Veiligheidsinformatie voor gebruik van de immobiliserende producten van Posey®

| Posey®


UITSLUITEND VOOR PRODUCTEN OP VOORSCHRIFT. Dit hulpmiddel mag volgens de Amerikaanse wet uitsluitend op voorschrift van een arts verkocht worden. Uitsluitend bestemd voor gebruik in medische instellingen met vergunning.

OPLEIDING MEDEWERKERS: Tidi biedt gratis trainingshulpmiddelen voor de praktijk. Neem hiervoor online contact op met Tidi op www.tidiproducts.com of bel gratis via 1.800.447.6739 (in de VS).

VÓÓR HET TOEPASSEN VAN EEN IMMOBILISATIEHULPMIDDEL: volg het beleid en de procedures van uw ziekenhuis inzake immobilisatie die voldoen aan de Amerikaanse CMS-richtlijnen en wetgeving of aan die van andere regelgevende instanties buiten de VS.

AANVULLENDE WAARSCHUWINGEN:

- Patiënten moeten ALTIJD volgens het instellingsbeleid gevuld worden. Verkeerd aanbrengen of verkeerde gebruik van immobilisatiehulpmiddelen kan resulteren in ernstig of dodelijk letsel. Denk eraan dat constant toezicht gewenst kan zijn voor:
 - agressieve of onrustige patiënten; en
 - achteroverliggende patiënten; controleer of deze houding niet tot complicaties leidt bij patiënten die zouden kunnen overgeven terwijl ze geimmobiliseerd zijn.
- Dit product mag NOOIT gewijzigd of gerepareerd worden. ALTIJD inspecteren vóór ieder gebruik: controleer op kapotte steken of onderdelen, op gescheurd, doorgesneden of gerafeld materiaal en op vergrendelingen, gespen en klittenbandsluitingen die niet goed werken. Vuile of beschadigde producten NIET gebruiken. Dat kan ernstig of dodelijk letsel veroorzaken. Beschadigde producten wegwerpen volgens het instellingsbeleid voor BIOLOGISCH GEVAARLIJK materiaal.
- Maak riempjes ALTIJD vast aan een gedeelte van het frame dat met de patiënt mee beweegt (niet aan voeten-/hoofdeinde of zijrails), buiten het bereik van de patiënt, met behulp van de snelkoppelingsbanden (zie onderstaande tekening) of gespen. Hiermee kan het hulpmiddel bij ongelukken of brand snel losgemaakt worden. Verricht een test om te verzekeren dat de riempjes niet te strak kunnen gaan zitten, niet los kunnen komen en niet kunnen slappen waardoor te veel speling ontstaat. In dat geval kan de patiënt van de stoel of het bed glijden, waardoor het risico op ernstig letsel of verstikking toeneemt. Het losmaken van de immobilisatiehulpmiddelen is een belangrijk aspect van brand- en rampenoefeningen bij de instelling. De riempjes kunnen in noodgevallen met een schaar worden doorgeknipt.
- Maak immobilisatiiriempjes NOOIT vast aan zijrails of hoofd-/voeteneinde.
- Gebruik Posey-producten NOOIT op toiletten of op stoelen of meubilair waarop de producten niet volgens de aanwijzingen voor het aanbrengen bevestigd kunnen worden. NIET thuis gebruiken.
- Dit product NOOIT blootstellen aan open vuur, brand, rokend materiaal of sterke warmtebronnen. Sommige producten kunnen smelten of ontbranden/verbranden. De regels voor al dan niet roken bij de instelling moeten strikt gehandhaafd worden.
- Gebruik Posey-producten NOOIT als veiligheidsgordel in rijdende voertuigen. Posey-producten zijn niet bestand tegen krachten die vrijkomen bij aanrijdingen of plotseling stoppen.
- Controleer vóór elk gebruik de rits- en klittenbandsluitingen. GOOI het hulpmiddel WEG als het niet goed bevestigd kan worden.



WASVOORSCHRIFT (waar van toepassing):

- Bevestig alle gespen en vergrendelingen om de kans op beschadiging tijdens het wassen en drogen te verminderen. Gespen en vergrendelingen mogen NIET door een wringer gehaald worden. Gebruik voor een maximale levensduur zo mogelijk een wasnet.
- Roestvrijstalen sloten: Posey raadt aan de sloten na het reinigen te behandelen met een droog smeermiddel (silicone). Spuit voor het beste resultaat een kleine hoeveelheid in het slot. Draai het slot een aantal keer open en dicht met de sleutel zodat alle oppervlakken goed worden gesmeerd.
- Trek alle ritsen dicht en keer het product binnenste buiten om de rits te beschermen voordat u het product wast.
- Klittenband kan na herhaald wassen pluis bevatten waardoor het minder goed vast blijft zitten. Bevestig de haakjes op de lusjes voor het wassen om de afzetting van pluis te beperken. Gebruik zo nodig een harde borstel om het pluis uit het klittenband te verwijderen.

Met uitzondering van de schuimrubberen producten kunnen deze producten in de wasmachine worden gewassen volgens de richtlijnen van de Amerikaanse CDC* voor met bloed of lichaamsvochtstoffen verontreinigd materiaal.

160°F / 71°C
HEET WASSEN 25 MIN.
 CI
BLEKEN VOLGENS AANWIJZINGEN OP FLES
 KOEL DROGEN

- Was en droog ongecontamineerd materiaal op lagere temperaturen zodat het product langer meegaat.

Voor schuimrubberen producten:

100°F / 38°C
LAUW WASSEN
 CI
BLEKEN VOLGENS AANWIJZINGEN OP FLES
 KOEL DROGEN


- Zorg ervoor dat de producten vóór gebruik volledig droog zijn.

OPSLAG EN GEBRUIKSINSTRUCTIES:

- Dit hulpmiddel is bestemd voor gebruik in een normale binnenomgeving.
- Dit hulpmiddel kan worden opgeslagen in magazijnen bij omgevingstemperatuur met een normale vochtigheidsgraad. Vermijd overmatig vocht of hoge vochtigheid waardoor het materiaal van het product beschadigd kan raken.

*www.cdc.gov

VASTMAKEN VAN DE POSEY-SNELKOPPELINGSBAND

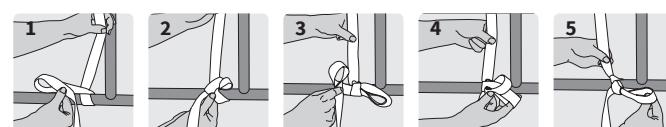

- Wikkelt het riempje éénmaal rond het frame dat met de patiënt mee beweegt (niet aan zijrails of hoofd-/voeteneinde bevestigen) en laat een gedeelte van minimaal 20 cm over. Vouw het losse uiteinde dubbel om een lus te vormen en leg deze over het andere uiteinde.
- Steek het omgevouwen riempje door de plaats waar de riempjes elkaar kruisen, net zoals bij het strikken van een schoenveter. Trek de lus strak.
- Vouw het losse uiteinde dubbel om een tweede lus te vormen.
- Haal de tweede lus door de eerste lus.
- Trek de lus strak. Controleer of het riempje goed vastzit en niet kan verschuiven.
- Herhaal dit aan de andere kant. Oefen in het snel losmaken van de riempjes om te verzekeren dat de knoop meteen loskomt als u aan het losse uiteinde van het riempje trekt.

NL

Meld een ernstig incident in verband met het gebruik van het hulpmiddel aan TIDI Products en de bevoegde instantie in de lidstaat. | Vertalingen van dit document in het Frans, Spaans, Nederlands, Duits, Italiaans en Portugees vindt u op www.tidiproducts.com/IFU.

VERWIJDEREN: gooi het product weg volgens de richtlijnen van de instelling, na dertig dagen gebruik of eerder indien het product is versleten of beschadigd.

EN

TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 VS
Telefoon: 1.800.447.6739 • Internationaal: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Alle rechten voorbehouden.

MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Duitsland

UKCA
UK Verantwoordelijke persoon
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Verenigd Koninkrijk

Support Caregivers.
Protect Patients.
I9200B REV E 2021-05-14



Informação de segurança para a utilização dos produtos de immobilização Posey®



Posey®

APENAS PARA PRODUTOS SOB PRESCRIÇÃO. A legislação federal dos EUA restringe a venda deste dispositivo por ou em nome de um médico. Para utilização apenas numa instituição de cuidados de saúde autorizada.


FORMAÇÃO DE PESSOAL: a Tidi facilita ajudas de formação no terreno sem quaisquer custos. Contacte a Tidi online em www.tidiproducts.com ou ligue para o número gratuito 1.800.447.6739.

ANTES DE APlicAR QUALQUER IMOBILIZADOR: siga as políticas e os procedimentos de immobilização do seu hospital que estejam em conformidade com as orientações dos CMS e a legislação estatal nos EUA, ou outras agências reguladoras fora dos EUA.



AVISOS ADICIONAIS:

- Monitorize SEMPRE o doente segundo a política da instituição. A aplicação ou utilização inadequada de qualquer immobilizador poderá resultar em lesões graves ou morte. Tenha em mente que poderá ser necessária uma monitorização constante para:
 - Doentes agressivos ou agitados; e
 - Doentes em posição supina; certifique-se de que o facto de estar nesta posição não causa quaisquer complicações para os doentes que apresentam risco de vómitos enquanto estão immobilizados.
- NUNCA altere nem repare este produto. Ispécione SEMPRE antes de cada utilização: verifique quanto à presença de pontos ou componentes danificados; material rasgado, cortado ou desgastado; ou bloqueios, fivelas ou fechos de velcro que não immobilizam com firmeza. NÃO utilize produtos sujos ou danificados. Isso poderia resultar em lesões graves ou morte. Elimine os produtos danificados segundo a política de materiais de RISCO BIOLÓGICO da instituição.
- Fixe SEMPRE as cintas a uma parte da estrutura que se move com o doente (que não seja o painel da cabeça/pés ou guardas laterais), fora do alcance dos doentes, utilizando nós (veja o esquema abaixo) ou fivelas de libertação rápida. Estes permitem uma libertação fácil em caso de acidente ou incêndio. Teste para garantir que as cintas não apertam, afrouxam ou criam folga em excesso. Se isto ocorrer, o doente poderá deslizar da cadeira ou cama, aumentando o risco de lesão grave ou asfixia. A libertação de immobilizadores é uma parte importante dos exercícios de desastres e incêndios na instituição. As cintas podem ser cortadas com tesoura numa emergência.
- NUNCA fixe cintas immobilizadoras à guarda lateral ou ao painel dos pés/cabeça.
- NUNCA utilize produtos Posey em sanitas ou em qualquer cadeira ou móvel que não permita uma aplicação adequada conforme indicado nas Instruções de aplicação. NÃO utilize em casa.
- NUNCA exponha este produto a chamas desprotegidas, fogo, materiais associados ao tabagismo ou fontes de elevado calor. Alguns produtos poderão derreter ou entrar em combustão e arder. A política de tabagismo/antitabagismo da instituição deve ser aplicada com rigor.
- NUNCA utilize um produto Posey como cinto de segurança num veículo em movimento. Os produtos Posey não foram concebidos para suportar a força de um acidente ou uma paragem repentina.
- Teste os fechos-ecler ou fechos de velcro antes de cada utilização. ELIMINE o dispositivo se o mesmo não apertar com segurança.



INSTRUÇÕES DE LAVAGEM (se aplicável):

- Aperte todas as fivelas e bloqueios para reduzir o risco de danos durante os ciclos de lavagem e secagem. NÃO coloque as fivelas ou bloqueios em máquinas de secar. Para uma vida útil máxima, lave dentro de um saco de lavagem.
- Bloqueios de aço inoxidável: a Posey recomenda que os bloqueios sejam tratados com um lubrificante de película seca (silicone) após cada limpeza. Para obter os melhores resultados, pulverize uma pequena quantidade no bloqueio. Movimente o mecanismo do bloqueio com uma chave várias vezes para garantir que todas as superfícies ficam bem lubrificadas.
- Antes da lavagem, feche o fecho-ecler e vire o produto do avesso para proteger o fecho-ecler.
- Os fechos de velcro poderão acumular fiapos após lavagens ou utilizações repetidas, reduzindo deste modo a força da aderência. Feche o velcro antes da lavagem para ajudar a prevenir a acumulação de fiapos. Conforme necessário, utilize uma escova de cerdas suaves para remover fiapos do lado dos "ganchos".

• Estes produtos, com a exceção dos produtos feitos de espuma, podem ser lavados à máquina em conformidade com as orientações da CDC* referentes a materiais sujos com sangue ou fluidos corporais.



- Para materiais não contaminados, utilize ciclos de lavagem e secagem de temperatura mais baixa para prolongar a vida útil do produto.

• Para produtos feitos de espuma:




- Certifique-se de que os produtos estão completamente secos antes da utilização.

ARMAZENAMENTO E MANUSEAMENTO:

- Este dispositivo foi concebido para utilização em ambientes interiores normais.
- Este dispositivo pode ser armazenado a temperaturas ambiente de armazém, a níveis normais de humidade. Evite o excesso de humidade que possa danificar os materiais do produto.

*www.cdc.gov

COMO FAZER O NÓ DE LIBERTAÇÃO RÁPIDA POSEY

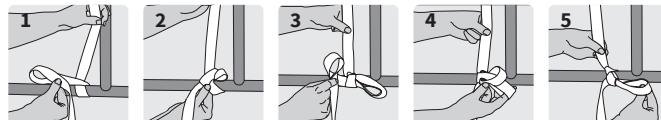

- Enrole a cinta em torno da estrutura que se move com o doente (não fixe à guarda lateral ou painel dos pés/cabeça), deixando uma sobra de pelo menos 20 cm (8 pol.). Dobre a extremidade solta a meio para criar um laço e cruze-a sobre a outra extremidade.
- Insira a cinta dobrada onde as cintas se cruzam, como se estivesse a apertar os cordões de um sapato. Puxe o laço para apertar.
- Dobre a extremidade solta a meio para criar um segundo laço.
- Insira o segundo laço no primeiro laço.
- Puxe o laço para apertar. Teste para garantir que a cinta está segura e não desliza em nenhuma direção.
- Repetir do outro lado. Pratique os nós de libertação rápida para garantir que o nó se desfaç puxando uma vez pela extremidade solta da cinta.



Deve comunicar qualquer incidente grave relacionado com a utilização do dispositivo à TIDI Products e à autoridade competente do Estado-Membro. | Traduções deste documento em francês, espanhol, neerlandês, alemão, italiano e português encontram-se em www.tidiproducts.com/IFU.

ELIMINAÇÃO: elimine o produto de acordo com as orientações da instituição ou após uma utilização de trinta dias, ou mais cedo, se o produto estiver desgastado ou danificado.



TIDI Products, LLC • 570 Enterprise Drive, Neenah, WI 54956 EUA
Telefone: 1.800.447.6739 • Internacional: +1.920.751.4036 • www.tidiproducts.com

© Posey Products, LLC. Todos os direitos reservados.



MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover,
Alemanha

UK Pessoa responsável
Emergo Consulting (UK) Limited
c/o Cr360 – UL International
Compass House, Vision Park Histon
Cambridge CB249BZ
Reino Unido

TIDI
Support Caregivers.
Protect Patients.
I9200B REV E 2021-05-14